


March 31<sup>st</sup>, 2026**Product code / Código de producto:** IT26-C**Product description / Descripción de producto:** Moving front chemical integrator for steam sterilization processes, (type 5 Integrating Indicator according to ISO 11140-1:2014 standard). / Integrador químico de frente progresivo para procesos de esterilización por vapor, (Indicador Integrador tipo 5 conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60152**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-03-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-02-28**Accept condition / Condición de aceptación:** Once the dark bar reaches the ACCEPT zone. / Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT.**Process specifications / Especificaciones de proceso:**SV<sub>121°C</sub> = 24.9 minSV<sub>128°C</sub> = 12.0 minSV<sub>135 °C</sub> = 2.8 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores

presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B60152** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60152** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.

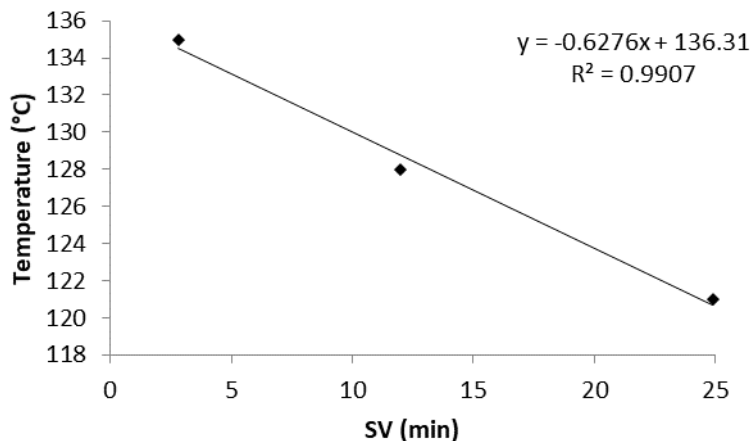

**TERRAGENE S.A.**

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO