


January 26<sup>th</sup>, 2026**Product code / Código de producto:** IT26SAD**Product description / Descripción de producto:** Unique point integrator indicator for steam sterilization processes in a self-adhesive support. Type 5 according to ISO 11140-1:2014. / Indicador integrador de un punto para procesos de esterilización por vapor en soporte autoadhesivo. Tipo 5 conforme a la norma ISO 11140-1:2014.**Batch number / Número de lote:** B60012**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-01-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-12-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Process specifications / Especificaciones de proceso:**SV<sub>121°C</sub> = 16.6 minSV<sub>128°C</sub> = 8.3 minSV<sub>135°C</sub> = 4.2 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only

under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B60012** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60012** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.

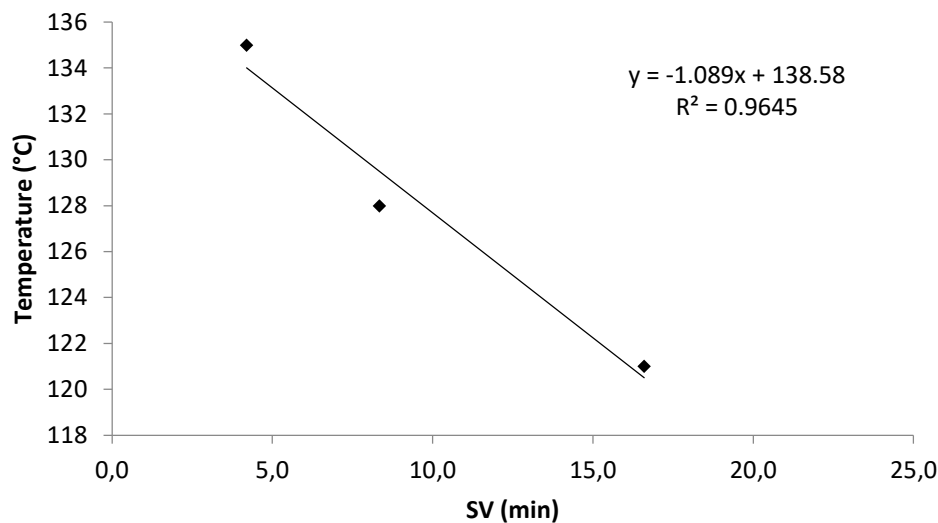

**TERRAGENE S.A.**  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO