

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

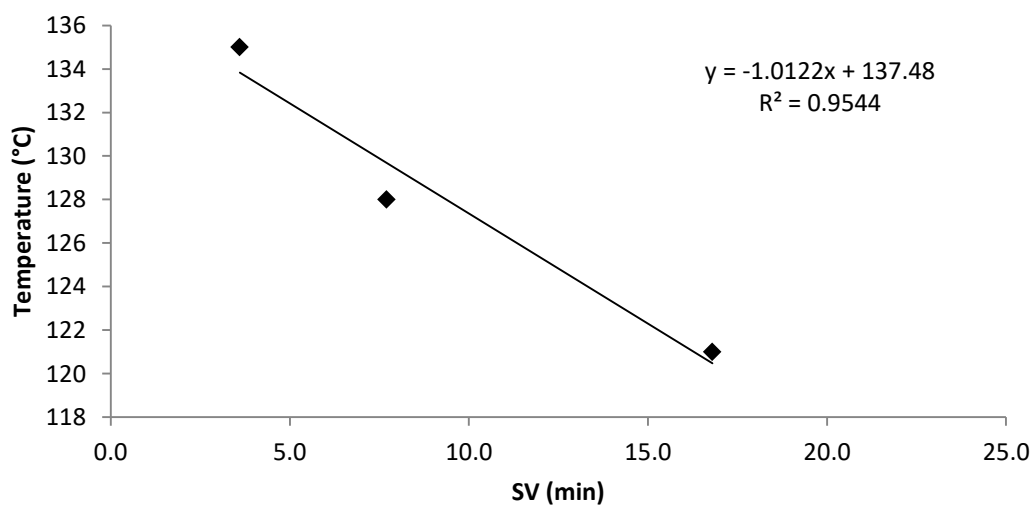
TERRAGENE®

November 13th, 2020Product code / Código de producto: IT26SBL

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Bilaminated strip, type 5 (according to ISO 11140-1). / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tira bilaminada, tipo 5 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: IT26SBL021120Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-11Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-11Transition color / Color de Transición: Turns to Green/Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV_{121°C} = 16.8 minSV_{128°C} = 7.7 minSV_{135°C} = 3.6 min

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT26SBL021120** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **IT26SBL021120** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO