

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

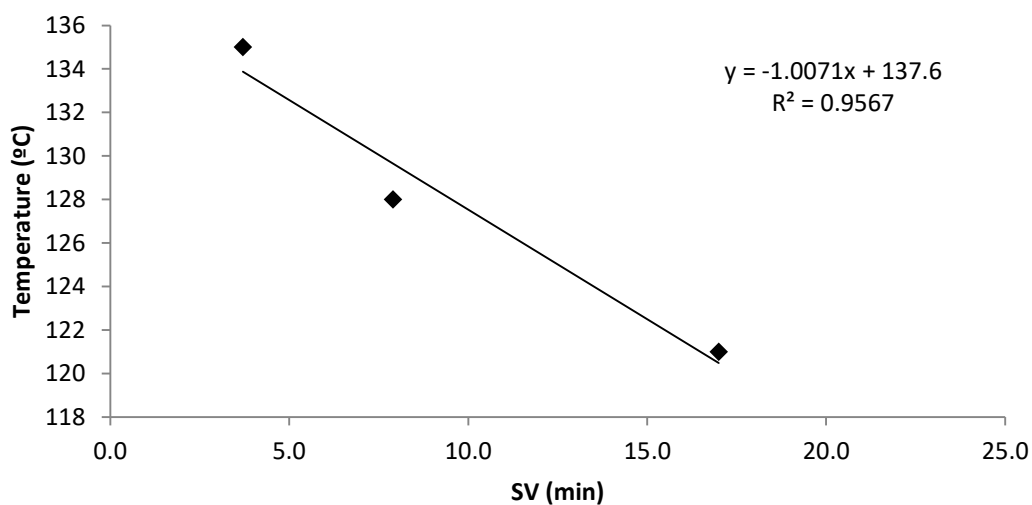
TERRAGENE®

October 22<sup>nd</sup>, 2020Product code / Código de producto: IT26SBL

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Bilaminated strip, type 5 (according to ISO 11140-1). / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tira bilaminada, tipo 5 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: IT26SBL061020Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-10Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-10Transition color / Color de Transición: Turns to Green/Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV<sub>121°C</sub> = 17.0 minSV<sub>128°C</sub> = 7.9 minSV<sub>135°C</sub> = 3.7 min

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **IT26SBL061020** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **IT26SBL061020** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO